

ANALIZA BIAŁEK



100004646

Laboratorium Analizy

Klient: Sprawdzam suple
Numer zamówienia: 100004646
Nazwa: NASSA LABS TRESTOLONE ACETATE
Ilość próbek: 1 fiolka

Numer partii: DL01/2023
Data przyjęcia: 2024-02-02
Data rozpoczęcia: 2024-02-06
Data zakończenia: 2024-02-07

Identyfikacja próbki

Szukana substancja	Metoda pobrania próbki	Postać
Trestolone Acetate	Próbka dostarczona przez klienta	Przezroczysty płyn w szklanej fiolce

Wyniki

Substancja	Nazwa próbki	Ilość	Czystość
Trestolone Acetate	NASSA LABS TRESTOLONE ACETATE 50MG/ML	53,78mg/ml	-----

Komentarz do badania

Badaną próbkę naniesiono w ilości 3ul na kolumnę BioBasic 8 Thermo Scientific. Podczas przebiegu analizy metodą gradientu liniowego w roztworach H2O oraz Acetonitrylu z dodatkiem 0,1% kwasu trifluorooctowego pojawił się pik szukanej substancji. Jego stężenie po przyrównaniu do chromatogramu wzorcowego wynosi 53,78mg/ml. Wysokość błędu pomiarowego wynosi +/- 1 mg. Stan faktyczny przesłanej próbki przed badaniem przedstawia zdjęcie poniżej

Zdjęcie badanej próbki




Hasło dostępu

W83WDB3E


Analiza Białek sp. z o.o.
KRS: 0000966168
NIP: 8992922970
REGON: 521751875

Siedziba i Laboratorium:
ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław
Budynek DELTA

Badanie przeprowadził:
Specjalista ds. analiz i badań
mgr Arkadiusz Zając



Chromatogram

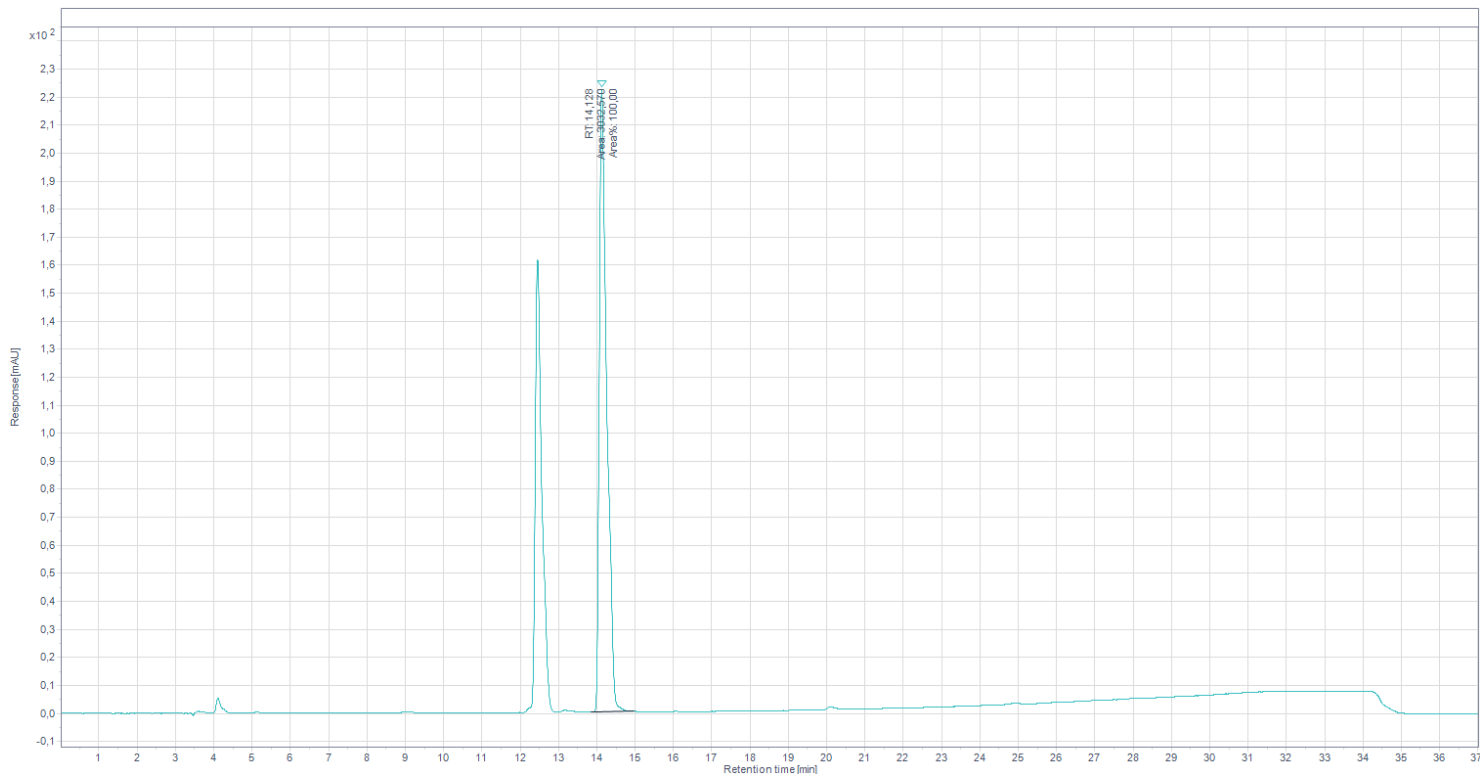

Metoda

Czas	H ₂ O + 0,1% TFA	ACN + 0,1% TFA
0min	60%	40%
2min	60%	40%
27min	5%	95%
30min	5%	95%

Hasło dostępu

W83WDB3E